점 검 내 역 서

담 당 자 김민경

자산코드	I0505060113-2010003	자 산 명	DIGITAL WEIGHT-HEIGHT SCALE
모 델 명	GL-15	S / N	
귀속부서	임상시험센터	설치장소	대기실

의뢰일자	2026-08-18	완료일자	2026-08-18
의뢰부서	임상시험센터	의 뢰 자	윤경희
자산구분	의료소모비품	사내전화번호	6518

의뢰내역	예방점검

일자	조치내역					
	부품코드	부품명	규격	수량	단가	금액
2026-08-18	-Main Power test ok -Power adaptor test ok -Key funtion test ok -Balance test ok -Weigh and height test ok -Funtion test ok					

총 수리비용(합계) 0원

건국대학교병원
KONKUK UNIVERSITY MEDICAL CENTER

점 검 내 역 서

담 당 자 김민경

자산코드	D121201004-2011003	자 산 명	AUTOMATIC BLOOD PRESSURE MONITOR
모 델 명	EASY X 800RP	S / N	EMD0362-100528
귀속부서	임상시험센터	설치장소	대기실

의뢰일자	2026-08-18	완료일자	2026-08-18
의뢰부서	임상시험운영팀	의 뢰 자	윤경희
자산구분	의료장비	사내전화번호	6518

의뢰내역	예방점검

일자	조치내역					
	부품코드	부품명	규격	수량	단가	금액
2026-08-18	-Case and printer funtion test ok -SYS/DIA funtion test OK (120/80) -Cuff leak test OK -Date/time calibration -Funtion test ok					

총 수리비용(합계) 0원

건국대학교병원
KONKUK UNIVERSITY MEDICAL CENTER

점 검 내 역 서

담 당 자 김민경

자산코드	D121302015-2010001	자 산 명	PATIENT MONITOR
모 델 명	MP1000NT	S / N	NTP-101-0345
귀속부서	임상시험센터	설치장소	처치실

의뢰일자	2026-08-18	완료일자	2026-08-18
의뢰부서	임상시험센터	의 뢰 자	윤경희
자산구분	의료장비	사내전화번호	6518

의뢰내역	예방점검

일자	조치내역					
	부품코드	부품명	규격	수량	단가	금액
2026-08-18	-Main power operating test ok -Battery power test ok -Operating funtion test(ECG, RR, SpO2, NIBP) ok -Printer operating test ok -Accessories(cable, 3-lead, cuff, sensor) status check ok					

총 수리비용(합계) 0원

건국대학교병원
KONKUK UNIVERSITY MEDICAL CENTER

점 검 내 역 서

담 당 자 김민경

자산코드	D121302015-2010002	자 산 명	PATIENT MONITOR
모 델 명	MP1000NT	S / N	NPT-101-0346
귀속부서	임상시험센터	설치장소	처치실

의뢰일자	2026-08-18	완료일자	2026-08-18
의뢰부서	임상시험센터	의 뢰 자	윤경희
자산구분	의료장비	사내전화번호	6518

의뢰내역	예방점검

일자	조치내역					
	부품코드	부품명	규격	수량	단가	금액
2026-08-18	-Main power operating test ok -Battery power test ok -Operating funtion test(ECG, RR, SpO2, NIBP) ok -Printer operating test ok -Accessories(cable, 3-lead, cuff, sensor) status check ok					

총 수리비용(합계) 0원

건국대학교병원
KONKUK UNIVERSITY MEDICAL CENTER

점 검 내 역 서

담 당 자 김민경

자산코드	D121302023-2016011	자 산 명	PATIENT MONITOR
모 델 명	MX450	S / N	DE35168534
귀속부서	임상시험센터	설치장소	처치실

의뢰일자	2026-08-18	완료일자	2026-08-18
의뢰부서	임상시험센터	의 뢰 자	윤경희
자산구분	의료장비	사내전화번호	6518

의뢰내역	예방점검

일자	조치내역					
	부품코드	부품명	규격	수량	단가	금액
2026-08-18	1.Visual Test -> PASS 2.Power on Test -> PASS 3.Basic Performance Assurance Test -> PASS 4.ECG/Respiration Performance -> PASS 5.ECG Out Performance Test -> PASS 6.SPO2 Performance Test -> PASS 7.NBP Performance Test -> PASS 8.Invasive Pressure Performance Test -> PASS 9. MSL Assurance Test -> PASS 10.Battery Performance Test -> Non-Pass 11.Power Loss Alarm Buzzer Performance Test -> PASS 12.Docking Station Performance Test -> PASS 13. Mounting Integrity Test -> PASS 14. Other Regular Test -> PASS 15. Protective Earth Test -> PASS 16. Equipment Leakage Current Test(Normal condition, Single Fault condition) -> PASS 17. Applied Part Leakage Current(Mains on Applied Part) -> PASS 18. Protective Earth Test -> PASS					

총 수리비용(합계) 0원

건국대학교병원
KONKUK UNIVERSITY MEDICAL CENTER

Biomedical Engineering
KONKUK UNIVERSITY MEDICAL CENTER

Preventive Maintenance Report

장비명	ECG Recorder
모델명	TC-30
귀속부서	건국대학교 의전원
점검일자	2026. 08. 18
점검자	김민경

조치내역

• **Visual Inspection : OK**
  ○ "No visible damage, cracks, or loose connections."
• **Power & Functionality Check : OK**
  ○ "Device powers on without error."
  ○ "Battery status is normal and holding charge."
  ○ "Display and control buttons are fully functional."
• Signal & Performance Verification : OK
  ○ "ECG signal acquisition is stable and free form noise."
  ▪ test instrument : Fluke Prosim 8
  ○ "Leads detect signals correctly; no dropout or interference observed."
• **Safety Checks**
  ○ "No abnormal heat or electrical leakage detected."
  ○ "Alarm and indicator lights functioning as expected."
• "The device is operating within normal parameters."


8/26/2026 3:49:53 PM

Rate	60	. AGE IS NOT ENTERED, ASSUMED TO BE 50 YEARS OLD FOR PURPOSE OF ECG INTERPRETATION
RR	1000	. SINUS RHYTHM
PR	164	
QRSD	92	
QT	360	
QTcB	360	
QTcF	360	
--AXIS--		
P	50	
QRS	34	
T	48	

- NORMAL ECG -

12 Lead; Standard Placement

Unconfirmed Diagnosis

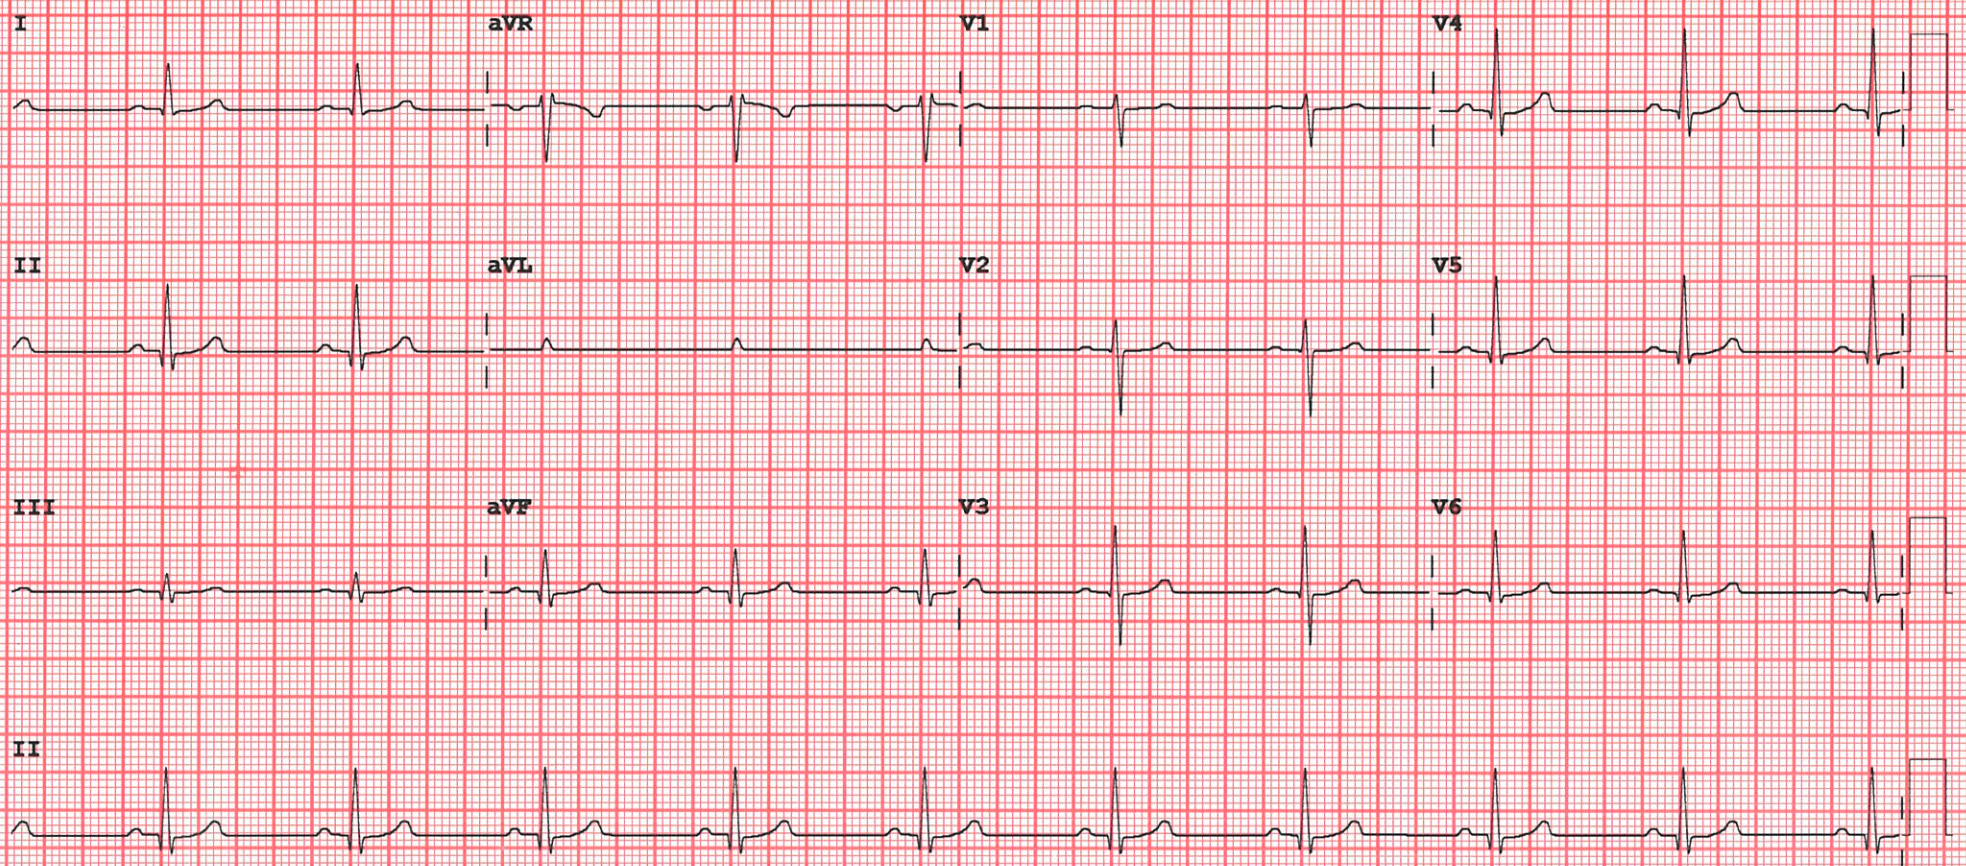

Device: Speed: 25 mm/sec Limb: 10 mm/mV Chest: 10.0 mm/mV F 60~ 0.50-100 Hz W PH090A P?

MEDI-GRAPH REORDER M3708A

Biomedical Engineering
KONKUK UNIVERSITY MEDICAL CENTER

Preventive Maintenance Report

장비명	피부 적외선체온계
모델명	HFS-1000
귀속부서	건국대학교병원 임상시험센터
점검일자	2026. 08. 18
점검자	김민경

조치내역
부서 요청으로 인한 외관 및 기능 점검 실시 • **Visual Inspection : OK** • **Power & Functionality Check : OK** • "The device is operating within normal parameters."